

Verbale n.3 del 30 ottobre 2024

Oggetto: R.D.O. n. 4148908- Procedura di gara sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera, suddivisa in tre lotti, di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo (lotto 1) – base di gara Euro 105.000,00, fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori (lotto 2) – base di gara euro 80.000,00, oltre iva e fornitura di n. 1 ventilatore polmonare da trasporto compatibile anche per l'utilizzo in sala RM comprensiva del materiale di consumo (lotto 3) – base di gara euro 35.000,00, oltre Iva-valore complessivo della fornitura euro 220.000,00, oltre iva - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa. esecuzione immediata

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di ottobre 2024 alle ore 10:45, sono presenti, presso la sede amministrativa di Via Ravaschieri, 8, in seduta pubblica sul M.E.P.A., giusta convocazione a mezzo MEPA del 24.10.2024, trasmessa sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominati con Determinazione Dirigenziale n.181 del 19.4.2024, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 3.6.2024, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dr. Agostino Cauteruccio– Dirigente medico Responsabile della U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva pediatrica del P.O. Pausilipon;

COMPONENTE: Dr. Giovanni Maria Di Marco– Dirigente medico in servizio c/o U.O.S.D. Cardiologia del P.O. Santobono;

COMPONENTE: Ing. Anna Trimarchi – Coll. tecnico ingegnere in servizio c/o U.O.S.D. Sistemi informativi aziendali;

SEGRETARIO: Dott. Riccardo Savastano – Coll. Amministrativo c/o P.U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al quale vengono affidate anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso:

1. che con deliberazione del Direttore Generale n.181 del 5.3.2024 è stata indetta una procedura di gara, sotto soglia comunitaria per la fornitura, con posa in opera, suddivisa in tre lotti, di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo (lotto 1) – base di gara Euro 105.000,00, fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori (lotto 2) – base di gara euro 80.000,00, oltre iva e fornitura di n. 1 ventilatore polmonare da trasporto compatibile anche per l'utilizzo in sala RM comprensiva del materiale di consumo (lotto 3) – base di gara euro 35.000,00, oltre Iva-valore complessivo della fornitura euro



GADN



220.000,00, oltre iva da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2. che in data 11.3.2024, con R.D.O. n. 4148908 sono stati invitati tutti gli Operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 5.4.2024;

3. che, entro il citato termine, sono pervenute offerte unicamente per il lotto n. 1 rubricato: "Fornitura con posa in opera di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo" e per il lotto n. 2 rubricato: "Fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori", di seguito indicate, distinte per lotto, unitamente agli estremi di ricezione desunte dalla piattaforma MEPA:

Lotto 1: Fornitura con posa in opera di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo


Operatore economico	Estremi di ricezione
1. Siare Engineering S.p.a.	04/04/2024 15:36:25
2. Burke & Burke S.p.a.	02/04/2024 17:19:34

Lotto 2: Fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori


Operatore economico	Estremi di ricezione
1. Elmed Service S.r.l.	04/04/2024 17:50:30
2. Burke & Burke S.p.a.	02/04/2024 17:25:14

Visto il verbale n. 1 del 15.5.2024 del Seggio di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta l'ammissione alla successiva fase di gara degli Operatori economici Siare Engineering S.p.a. e Burke & Burke S.p.a. per il lotto n. 1 e degli Operatori Elmed Service S.r.l. e Burke & Burke S.p.a. per il lotto n.2, mentre, relativamente al lotto n. 3 rubricato: "Fornitura di n. 1 ventilatore polmonare da trasporto compatibile anche per l'utilizzo in sala RM comprensiva del materiale di consumo" si è preso atto che nessun Operatore economico ha collocato la propria offerta sulla piattaforma MEPA.

Visto il verbale n. 2 del 25.6.2024 della Commissione di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti" dal quale risulta l'apertura sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche digitali delle Ditte ammesse a tale fase della procedura, la cui documentazione è stata acquisita dalla Commissione su supporto informatico ed assunta in custodia dal Presidente, per l'esame in seduta riservata della conformità dei prodotti offerti al capitolato tecnico e l'attribuzione dei punteggi di qualità.



6107



Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche pervenute, compiuto nelle sedute riservate riportate in allegato, la relazione tecnica e le schede allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale, nelle quali è riportato il punteggio di qualità, attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Pertanto, la Commissione ha proceduto a valutare unicamente la Ditta Adria.Med S.r.l. il cui esito, di seguito si riporta:

Lotto 1: Fornitura con posa in opera di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo

Operatore economico	Punteggio tecnico di qualità
1. Siare Engineering S.p.a.	80
2. Burke & Burke S.p.a.	77,95



Lotto 2: Fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori

Operatore economico	Punteggio tecnico di qualità
1. Elmed Service S.r.l.	80
2. Burke & Burke S.p.a.	76,29

In prosieguo, la Commissione procede all'inserimento dei giudizi di qualità sulla piattaforma MEPA ed all'apertura delle offerte economiche e dei relativi dettagli economici di tutte le Ditte ammesse a questa fase come di seguito indicato:

Lotto 1: Fornitura con posa in opera di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo

Operatore economico	Punteggio tecnico di qualità	Punteggio economico	Prezzo offerto	Punteggio totale
1. Siare Engineering S.p.a.	80	20	€ 65.481,00	100
2. Burke & Burke S.p.a.	77,95	0,42	€ 104.157,00	78,37

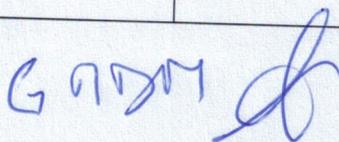
Lotto 2: Fornitura con posa in opera di n. 11 cardio-monitor defibrillatori

Operatore economico	Punteggio tecnico di qualità	Punteggio economico	Prezzo offerto	Punteggio totale
1. Elmed Service S.r.l.	80	2,27	€ 78.397,00	82,27
2. Burke & Burke S.p.a.	76,29	20	€ 65.890,00	96,29


La Commissione riscontrata la conformità dell'offerta economica di tutte le Ditte ammesse, propone di aggiudicare la fornitura, con posa in opera di n. 2 macchine di anestesia amagnetiche comprensiva del materiale di consumo (lotto 1), all'Operatore economico SIARE Engeneering S.p.a. che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad Euro 65.481,00; mentre, la medesima Commissione propone di aggiudicare la fornitura, con posa in opera, di n. 11 cardio-monitor defibrillatori (lotto 2) all'Operatore economico Burke & Burke S.p.a. che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad Euro 65.890,00

La Commissione di gara, ultimati i lavori, rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza.



La seduta termina alle ore 11:40

Del che è verbale che viene letto confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

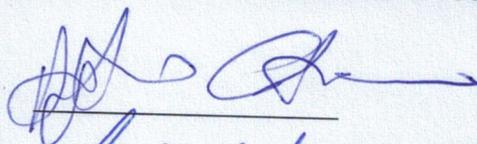

I COMPONENTI

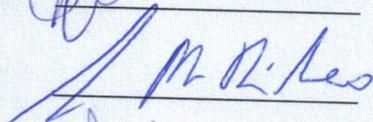IL SEGRETARIO



Oggetto: Valutazione tecnica – Fornitura con posa in opera di n. 11 cardiomonitor defibrillatori (lotto 2)

Con la presente si redige la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte BURKE & BURKE e ELMED.

Criterio n. 1: Caratteristiche della defibrillazione

Le caratteristiche sono in larga parte sovrapponibili. Il defibrillatore della ditta ELMED ha ricevuto un punteggio lievemente superiore in virtù di un tempo di ricarica alla massima energia a 360J inferiore a 7 secondi; Il prodotto offerto dalla ditta BURKE & BURKE ha un tempo di ricarica inferiore agli 8 secondi.

Criterio n. 2: Caratteristiche parametri fisiologici monitorati

Caratteristiche sovrapponibili.

Criterio n. 3: Indicatori acustici visive per ausilio operatore e segnalazione allarmi

Caratteristiche sovrapponibili.

Criterio n. 4: Autonomia e tempo ricarica batteria

Il prodotto BURKE & BURKE ha ricevuto un punteggio superiore in virtù di un'autonomia superiore (10h Vs 6,5h in monitoraggio) e tempi inferiori per una ricarica completa (3h Vs 4h);


Criterio n. 5: Dimensioni Display, Peso (incluso batteria), trasporto, ingombro

Il prodotto BURKE & BURKE ha ricevuto un punteggio inferiore in virtù di dimensioni e risoluzioni inferiori del display (8,5" e 800 x 600 Vs 9" e 1200 x 1020) con minore possibilità di visualizzazione di forme d'onda (fino a 5 Vs fino a 7). Presenta, inoltre, un peso maggiore ($\leq 7,5\text{Kg}$ incluse Batterie e Piastre Vs 4,5 Kg con batteria). Inoltre, il monitor proposto dalla ditta ELMED è touchscreen.


Criterio n.6: Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presentare documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale)

In entrambe le offerte presentate le Ditte dichiarano la disponibilità di personale tecnico deputato all'assistenza tecnica. Da documentazione risulta comunque che unicamente la ditta ELMED fornisce assistenza tecnica con personale in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante.

dott. Agostino Cauteruccio
Responsabile U.O.S.D. Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica Pausilipon

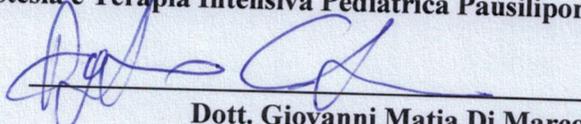

Dott. Giovanni Matia Di Marco
U.O.S.D. Cardiologia Pediatrica



Ing. Anna Trimarchi
U.O.S.I.D. Sistemi e Flussi Informativi Aziendali

LOTTO 02


Handwritten signatures and initials in blue ink:
 1. A stylized signature.
 2. The initials "GMM".
 3. A stylized signature.

		Burke & Burke	Elmed
Caratteristiche della defibrillazione	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	20,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	20,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	1,00
Caratteristiche parametri fisiologici monitorati	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	20,00
	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	18,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00

	Punti qualità attribuiti Commissario 3	18,00	18,00
Indicatori acustici visive per ausilio operatore e segnalazione allarmi	Punti massimi attribuibili	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,00	14,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,00	14,00
	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	10,50
Autonomia e tempo ricarica batteria	Giudizio Commissario 2	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00	10,50
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00	10,50
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	10,50


 GARDI


Dimensioni Display, Peso (incluso batteria), trasporto, ingombro		Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presentare documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale) Si: 3 punti No: 0 punti	Punti massimi attribuibili	Giudizio Commissario 1	0,70	1,00
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00	10,00
		Giudizio Commissario 2	0,70	1,00
		Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,00	10,00
		Giudizio Commissario 3	0,70	1,00
		Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,00	10,00
		Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
		Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	3,00
		Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
		Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	3,00
Giudizio Commissario 3	0,00	1,00		


 GNDT


	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	3,00
--	---------------------------------------	------	------

AL


[Signature]

69077

69077

GADN

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Burke & Burke	Elmed
Punti qualità attribuiti Comm.1	72,00	75,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	72,00	75,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	72,00	75,50
Media dei punti di qualità attribuiti	72,00	75,50
Punteggio massimo attribuito	75,50	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Burke & Burke	Elmed
Coefficiente di riparametrizzazione	0,95	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Burke & Burke	Elmed
Punti qualità riparametrizzati	76,29	80,00

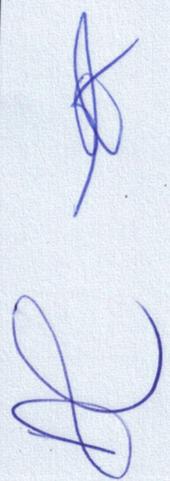

LOTTO 02

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Burke & Burke	76,29
Elmed	80

DL

8

61809

LOTTO 02

AGGIUDICATARIA

Burke & Burke

80% qualità - 20% prezzo

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPASSO	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE		PUNTEGGIO TOTALE
				GARA	PREZZO PIU' BASSO	
Burke & Burke	76,29	20	65.890,000	80.000,000	65.890,000	96,29
Elmed	80	2,272	78.397,000			82,27

NOTE

WGS

Oggetto: Valutazione tecnica – Fornitura con posta in opera di due sistemi anestesia amagnetiche (lotto 1)

Con la presente si redige la valutazione tecnica delle offerte presentate dalle ditte BURKE & BURKE e Siare.

Criterio n. 1: Caratteristiche ventilatorie (tecniche ventilatorie disponibili, Modalità di avvio e parametri rilevati in sede di autotest)

Le tecniche ventilatorie sono sovrapponibili così come i parametri rilevati in sede di autotest. Il prodotto SIARE ha ricevuto una valutazione lievemente superiore in virtù di una durata inferiore dell'autotest (15'' Vs 240'').

Criterio n. 2: Monitoraggio parametri di ventilazione (Numero e tipologia dei parametri di ventilazione monitorati, Numero e tipologia di allarmi sui parametri di ventilazione, curve loop e parametri visualizzabili, ecc)

I prodotti offerti risultano essere praticamente sovrapponibili.

Criterio n. 3: Ergonomia, facilità di utilizzo ed interfacciabilità (Caratteristiche consumabili paziente, Caratteristiche e quantità delle interfacce di comunicazione in dotazione, Caratteristiche e proprietà interfaccia utente, dimensioni e tipologia monitor)

Le caratteristiche analizzate sono in gran parte sovrapponibili per i due prodotti. Il prodotto SIARE ha ricevuto una valutazione lievemente superiore in virtù di un peso inferiore (72 Kg Vs 137 Kg).

Criterio n. 4: Range Volume Corrente

Caratteristiche sovrapponibili.


Criterio n. 5: Riconoscimento automatico gas alogenati

Caratteristiche sovrapponibili. Entrambi i prodotti hanno la possibilità di riconoscimento automatico gas alogenati.


Criterio n.6: Durata batteria macchina anestesia

La durata della batteria è lievemente superiore nel prodotto Burke ($\geq 100'$ Vs $\leq 90'$).


dott. Agostino Cauteruccio
Responsabile U.O.S.D. Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica Pausilipon



Dott. Giovanni Matia Di Marco
U.O.S.D. Cardiologia Pediatrica

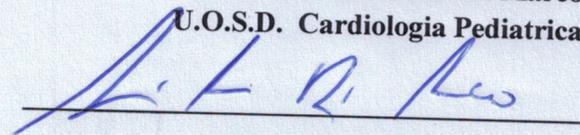


Ing. Anna Trimarchi
U.O.S.I.D. Sistemi e Flussi Informativi Aziendali



LOTTO 01

		SIARE	BURKE & BURKE
Caratteristiche ventilatorie (tecniche ventilatorie disponibili, Modalità di avvio e parametri rilevati in sede di autotest)	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	20,00	18,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	20,00	18,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	20,00	18,00

DE GARDI

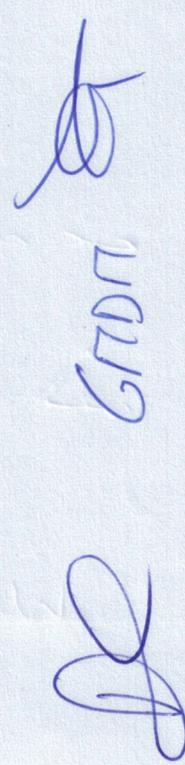

<p>Monitoraggio parametri di ventilazione (Numero e tipologia dei parametri di ventilazione monitorati, Numero e tipologia di allarmi sui parametri di ventilazione, curve loop e parametri visualizzabili, ecc)</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>			
				<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>
				<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>
				<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>
				<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>
				<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>
<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>20,00</p>	<p>20,00</p>				



 GADP

<p>Ergonomia, facilità di utilizzo ed interfacciabilità (Caratteristiche consumabili paziente, Caratteristiche e quantità delle interfacce di comunicazione in dotazione, Caratteristiche e proprietà interfaccia utente, dimensioni e tipologia monitor)</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>	<p>0,80</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	<p>10,00</p>	<p>8,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>1,00</p>	<p>0,80</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 2</p>	<p>10,00</p>	<p>8,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 3</p>	<p>1,00</p>	<p>0,80</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 3</p>	<p>10,00</p>	<p>8,00</p>
<p>Range Volume Corrente</p>	<p>Punti massimi attribuibili</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 1</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>
	<p>Punti qualità attribuiti Commissario 1</p>	<p>10,00</p>	<p>10,00</p>
	<p>Giudizio Commissario 2</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>

DE GADP

Riconoscimento automatico gas alogenati SI: 10 punti - NO: 0 punti	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00	10,00
Durata batteria macchina anestesia	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00	10,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	8,00	10,00
Giudizio Commissario 3	0,80	1,00	
Punti qualità attribuiti commissario3	8,00	10,00	




TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SIARE	BURKE & BURKE
Punti qualità attribuiti Comm.1	78,00	76,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	78,00	76,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	78,00	76,00
Media dei punti di qualità attribuiti	78,00	76,00
Punteggio massimo attribuito	78,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SIARE	BURKE & BURKE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,97
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SIARE	BURKE & BURKE
Punti qualità riparametrizzati	80,00	77,95

DE GADM

LOTTO 01

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
SIARE	80
BURKE & BURKE	77,95

DL

[Handwritten signature]

60707

LOTTO 01



AGGIUDICATARIA

80% qualità - 20% prezzo

SIARE

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE	PREZZO PIU'	PUNTEGGIO TOTALE
				GARA	BASSO	
SIARE	80	20	65.481,600	105.000,000	65.481,600	100
BURKE& BURKE	77,95	0,427	104.157,000			78,38

NOTE



UGV9